

Quality through Experience

**ERWEKA®**




## Konformitätserklärung *Declaration of Conformity*

**Dissolutions-Testgerät, Typ DT620**  
*Dissolution Tester, type DT620*

ERWEKA GmbH  
Ottostr. 20-22  
D-63150 Heusenstamm

Telefon: (06104) 69 03 0  
Telefax: (06104) 69 03 40

**Geschäftsführer**  
**Managing Director**  
Werner G. Müller  
Christian G. Müller  
Amtsgericht Offenbach  
HRR 2382

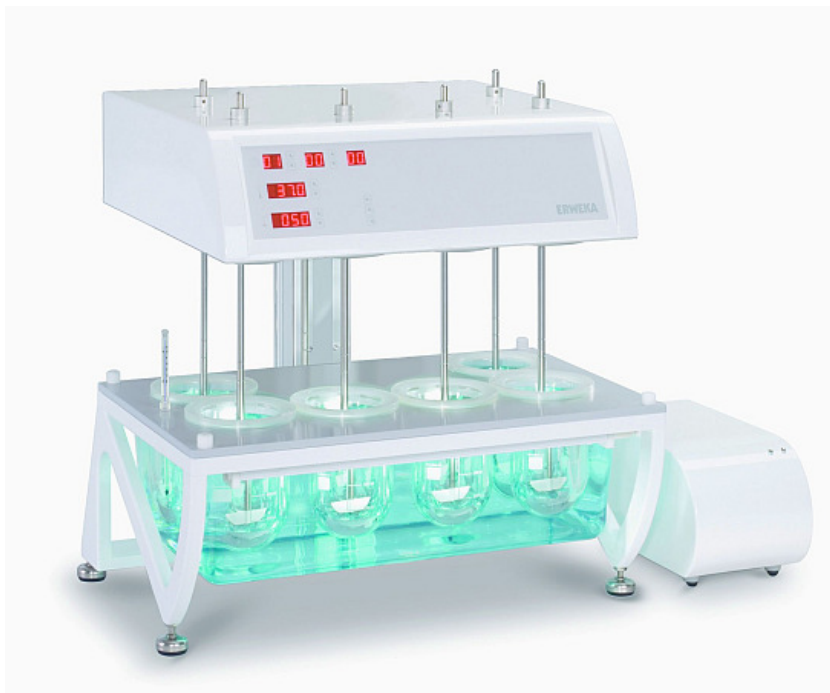

Für die Dissolutions-Testgeräte, Typen DT620, bescheinigen wir in alleiniger Verantwortung die Übereinstimmung mit den Forderungen der USP34 und der European Pharmacopoeia 7<sup>th</sup> Edition.

Hinweis: Rührwerkzeuge, Glasbehälter, Prüfwerkzeuge etc. verfügen jeweils über separate Konformitätserklärungen.

*For the ERWEKA Dissolution Tester, type DT620, we declare in our sole responsibility the conformity to USP34 and the European Pharmacopoeia 7<sup>th</sup> Edition.*

Note: Declaration of conformities regarding paddles, baskets and vessels etc. are issued separately.

Heusenstamm, den 07.02.2011

i.A.

  
Günter Annacker  
- Quality department -